



Neurophone®

Strobel / Service / Vertrieb



Handbuch

Flanagan Neurophone NF3

Inhalt, Garantie

- 3 Das Neurophone – das Meditationsgerät
- 4 Lieferumfang
- 5 Funktion, Bedienung
- 6 - 7 Schallwandler
Hörtest
Handfläche-Fühltest für Sensible
Zungenspitze-Fühltest für Alle

Audio-Einspielung
Lautstärke-Regler
- 7 - 9 Handhabung
9 Audio-(IN)-Signale nutzen
10 Anschluss-Optionen
11 Ein NF3 für Drei!
- 12 Batteriewechsel
13 Batterieempfehlung
13 Original Flanagan CD
- 14 Kraft der Pyramiden
15 Pyramiden Medaille Sensor V
- 16 Kontakt

© Copyright / alle Rechte:
Hanns Martin Strobel

Neurophone NF3 mit permanentem Grundrauschen:

Länge x Breite x Höhe
11,1 x 6,7 x 2,2 cm

inkl. Alkaline Batterie, zirka 130 g

Batterie (bei Lieferung)

9-V-Block Batterie, zirka 45 g
Standard Typ 6LR61 / 6F22
typische Ladung 500 - 600 mAh

Schallwandler

mit 2 Edelstahl-Membranen, 27 mm², 19 g

2 Jahre Garantie auf das Flanagan Neurophone NF3

Keine Garantie auf flexible Leitungen,
Batterie, Schallwandler, Adapter.


Keine Garantie bei Schäden durch
mechanische Einwirkungen und Flüssigkeiten
wie z. B. auch Körperschweiß.

Mit Ihrem Flanagan Neurophone NF3
gewinnen Sie ein neues Lebensgefühl,
steigern Meditation, Entspannung,
Lernen und Erinnerung!

Das Neurophone – das Meditationsgerät...

...für Ihre ‚elektromagnetische Bewusstseinsbasis‘ und Ihre Lebensenergie.

Mit dem **Flanagan Neurophone** können Sie alle Körperzellen mit sanften, elektromechanischen Ultraschall-Schwingungen aktivieren und somit auch die Gehirnhälften synchronisieren. Sie gewinnen ein neues Lebensgefühl, steigern Meditation, Entspannung, Lerneffekte und Erinnerung. So positiv berichten Personen, die ihr **Flanagan Neurophone** täglich morgens, tagsüber, vor dem Schlafen, die ganze Nacht oder durchgehend nutzen.

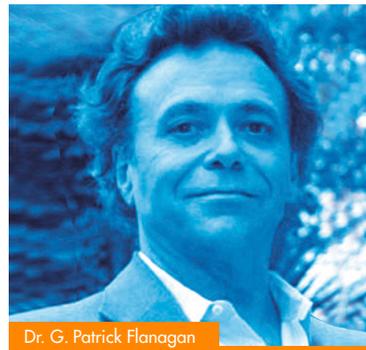

Dr. G. Patrick Flanagan

Dr. G. Patrick Flanagan entwickelte seine Neurophone zur Perfektion.

Er konnte beweisen, dass sich der Intelligenzquotient (IQ) mit zunehmender Synchronisation der Gehirnhälften signifikant verbessert.

Dr. Batteau, der als Forscher an der Tufts University in Boston lehrte, lud den 21-jährigen Patrick Flanagan mit seiner Neurophone-Erfindung zu einem Forschungsprojekt der Kommunikation zwischen Menschen und Delphinen ein. Hieraus ergaben sich Erfahrungen für die Optimierung und den vielseitigen Nutzen der Neurophone.

Der dezente Ultraschall der **Original Flanagan Neurophone** wird vom Sacculus im Innenohr empfangen. Das Sacculus ist das Organ des Gleichgewichtssinns.

Mit **Original Flanagan Neurophonen** können Sie sowohl im Schlaf als auch im Wachzustand Nervosität und Stress vermindern und sich von ‚Elektrostress‘ entlasten. Daraus kann sich ein präventiver Nutzen für Ihre Bereiche Lebensenergie und Gesundheit ergeben.

Superlearning

1971 propagierte der bulgarische Arzt Dr. Georgi Lozanov die Suggestopädie für beschleunigtes Lernen.

Balancieren Sie Ihr Gehirnwellenspektrum mit Hilfe eines Neurophones für Ihr individuelles **Superlearning**.

Der Status der Delta-, Theta-, Alpha- und Beta-Frequenzen im Bereich von 0,5 bis 35 Hz kann mit einem EEG (Elektroenzephalogramm) analysiert werden.

Lieferumfang



Neurophone NF3 mit Adaptern

Neurophone NF3 mit lösbarem Halteclip und 9-Volt-Block Batterie (im Batteriefach)



2 Schallwandler für Meditation

mit je 2 Membranen aus Edelstahl; Flachbandleitung, zirka 1200 mm; Winkelstecker, 3,5 mm Klinke; Gleithülse, zirka 12 mm; Klettband, zirka 110 x 16 mm.



Adapter und Holzstab

Der Holzstab ist sehr nützlich!

1 Adapterkabel zur Verbindung von „IN“ zur Kopfhörer-Buchse eines „Players“.

2 Adapter (Splitter/Doppelstecker), 3,5 mm Klinke, als handelsübliches Teil mit einem Stecker und zwei Buchsen.

1 Holzstab 28 mm x 4 mm° (Batteriefach)

- Abstandhalter zwischen Wand und Stecker
- zum Lösen des Batteriesteckers
- zum Einstellen der Ausgangsspannung

1 Original Flanagan CD

mit Wasserrauschen und Affirmationen in Deutsch und Englisch



CD mit Affirmationen

Funktion, Bedienung

Funktion

Das Ausgangssignal mit einstellbarer Lautstärke und Spannung (5 bis 20 V) hat eine konstante Grundfrequenz von etwa 40 kHz (Ultraschall). Das Ausgangssignal enthält in jeder Betriebsart das **interne Grundrauschen**, auch bei Lautstärke-Minimum. Dieses anpassungsfähige Grundrauschen interagiert mit Ihrer Person sowie Veränderungen an den Einstellungen bzw. Einflüssen aus der Umgebung und kann bei höherer Ausgangsspannung sogar leiser werden.

Das Einkoppeln von Audio(IN)-Signalen (z.B. für Lernzwecke, Entspannung und Schlafhilfe bei Lärmbelastung) kann den unterbewussten (subliminalen) Nutzen verstärken.

Das interne Grundrauschen sowie Audio(IN)-Signale werden durch ultraschall-angeregten Resonanzschall auch akustisch hörbar.

EIN/AUS, Lautstärke, Leuchtdiode (LED)



EIN/AUS und Lautstärke

Leuchtdiode (LED)

Das Lichtsignal dient als Betriebsanzeige mit von der Batteriereserve abhängiger Helligkeit. Die Abnahme der Helligkeit wird bei etwa 4 Volt erkennbar.

Lautstärke-Stellbereich:

Drei sichtbare Längen des Drehrads:
 $3 \times 90^\circ = 270^\circ$
Das Drehrad hat keine Schalfunktion!



Ausgangsspannung

Ausgangsspannung (Sp_g.)

Durch Linksdrehen erhöhte Sp_g. bewirkt lauteres Hören eingespielter Audio(IN)-Signale. Bei 5 V (Minimum) und neuer Alkaline Batterie kann die Betriebsdauer des NF3 bis zu 50 Stunden betragen. Höhere Sp_g. führt zu proportional höherem Stromverbrauch.

Schallwandler

Die Membranen werden elektromechanisch in Schwingung versetzt. Die Auslenkung (Amplitude) bewegt sich im Mikrometerbereich. Die physiologischen Schwingungseffekte bleiben auch bei Minimum-Einstellung von Lautstärke und Ausgangsspannung voll wirksam!

Audio-Einspielung

Bringen Sie den Stecker des Schallwandlers bis zum Anschlag in die Buchse OUT. Verbinden Sie die Buchse IN per Adapterkabel (an jedem Ende ein 3,5 mm Klinkenstecker) mit der Kopfhörerbuchse Ihres individuellen Wiedergabegerätes (Player).



Eingang / Ausgang

Für große Audio-Player mit Klinkenbuchse mit 6,3 mm Durchmesser gibt es handelsübliche Zwischenstecker (Adapter) für den Übergang von 6,3 mm Format auf 3,5 mm.

Hörtest

ON, max. Lautstärke, Spg. = 5 V, Stecker in OUT: Die mit Metall zu Metall zusammen gehaltenen Membranen mit einer Klebfläche auf einen Gehörgang andrücken. Zum ersten Wahrnehmen des internen Grundrauschens kann ein **kurzer Hörtest** an der linken Seite eines Kopfhörers in der OUT Buchse erfolgen.

Lautstärke-Regler



Maximum empfohlen für Hörtest. Betrieb mit Grundrauschen auch bei Minimum-Einstellung. **Audio-(IN)-Signale werden vom Minimum-Anschlag ausgehend ab einer halben Bogenlänge zunehmend wahrnehmbar.** Lautstärke Steigerung hat geringen Einfluss auf den Stromverbrauch.

Das NF3 hat dank des permanenten Grundrauschens 100 % physiologische Wirkung, auch ohne Audio-(IN)-Signal sowie bei Lautstärke-Minimum.

Handfläche-Fühltest für Sensible

ON, min. Lautstärke, Spg. = 5 V ergibt schon die volle physiologische Wirkung. Energie-fühlige Personen empfinden mit der Mitte einer Hand über einer Membran bei sehr langsamer auf und ab Bewegung Wärme, Kühle, Kribbeln oder evtl. eine nach oben oder nach unten wirkende Kraft.

Zungenspitze-Fühltest für Alle

ON, max. Lautstärke, Spg. = 20 V: Einen Daumen auf einer Membran und die Zungenspitze mit zirka 1 x 1 mm an die andere Membran ergibt ein enormes Vibrationsgefühl, das bei Andrücken der Zungenspitze sofort verschwindet.

Handhabung

Die beliebteste und sicherste Platzierung des **Flanagan Neurophone NF3** ist der Bauchbereich, im Rock- oder Hosenbund mit der Frontseite dem Körper zugewandt. Der Halteclip steckt dann am Bund nach außen. So besteht beim Bücken weder ein Clip-Bruchrisiko noch eine NF3-Absturzgefahr. Eine Tragetasche wäre eine Alternative.



Verdecktes Tragen



Ideale Trageposition



Tragen mit MP3 Player

Membranen platzieren

Die optimale Platzierung und der Abstand resultieren aus Zielsetzung und Erfahrungen.



Konzentration, Lernen

Die Schallwandler-Gleithülse bei Bedarf, z.B. zum Schlafen, nur so leicht wie möglich anspannen.

Die Wahrnehmung von Audio-Signalen ist z.B. bei Platzierung im Stirnbereich mit verstärktem Hautkontakt am besten.

Fixierungshilfen: Klettband, Stirnband, Pflaster, Mütze, Helm, usw.

Allgemeine Empfehlung:

Die Membranen können von Kopf bis Fuß auch unsymmetrisch angelegt werden. Für die rein physiologischen Effekte ist minimaler Hautkontakt ausreichend.

Bevorzugte Stellen: Kopf, Nacken, Schulter



Mit den Leitungen in Berührung kommende Hautflächen vor dem Anlegen mit einem trockenen Tuch neutralisieren.

Auf knick- und drillfreie Leitungsführung achten!

Es bedarf einige Tage der Anwendung ohne oder mit Audio-Signal zu je 60 Minuten oder länger, um Erfahrungen zu sammeln. Das kann während des Ruhens, irgendeiner Tätigkeit oder des Schlafens geschehen.

Folgen Sie bezüglich der Nutzungsdauer Ihrer Intuition. Platzieren Sie die Schallwandler auch an beliebigen Stellen Ihres Körpers. Prüfen Sie Ihre Empfindungen sowohl im Alltag als auch in belastenden und schmerzlichen Situationen.



Beobachten und notieren Sie für sich selbst die Effekte und Wirkungen Ihres Original Flanagan Neurophones:

... auf den Weg zu besserer Gesundheit / wie Sie von anderen Personen wahrgenommen werden / beim Einschlafen, während und nach dem Schlafen, sowie in Bezug auf Träume / auf die 5 Sinne / während des Arbeitstages / bei einer Autofahrt oder Flugreise / bei musischer Aktivität / bei physischer, sportlicher, feinmotorischer Beanspruchung (Sprechen, Fingerübungen, Tanz) / bei Meditationen / bei traumatischer Belastung / bei dem Ändern von Verhaltensmustern / während Unterrichtsstunden, Vorlesungen, Vorträgen oder Konzerten / wenn Sie sich in freier Natur befinden / wenn Sie sich Wissenstoff einprägen bzw. abrufen / usw.

Erleben Sie die Klänge einer Orgel- oder Orchestermusik bei gleichzeitig direkt auf die linke und rechte Ohrmuschel angedrückten Membranen.

Tiere und Pflanzen können in die experimentelle Anwendung einbezogen werden.



Audio-(IN)-Signale nutzen

In das NF3 eingespielte Klang- und Sprachsignale können verstärkend wirken für geistige Entwicklung im Bewusstsein und im Unterbewusstsein, für Wohlbefinden, Lerneffekte und Gedächtnis.

Das Einspielen der mitgelieferten Original Flanagan CD kann sehr hilfreich sein.

Optionen:

1. NF3 mit eingespieltem Tonsignal und parallel Audio-Kopfhörer
2. NF3 mit eingespieltem Audio-Signal





Tonaufnahmen mit minderer Qualität können sehr bedauerlich sein. Diese Qualität ist jedoch in Bezug auf eine gewünschte Wirkung von untergeordneter Bedeutung, wenn das Wesentliche für Sie wahrnehmbar ist.

Das NF3 wandelt das Audio-Signal des Players vom Stereo- zum Mono-Signal.

Die Entwicklung Ihrer empfundenen Realität hängt von den Informationen ab, die Ihr Unterbewusstsein prägt.

Anschluss-Optionen

Die mögliche Parallelanwendung von 2 Schallwandlern und von 2 Splitttern eröffnet interessante Perspektiven für eine bzw. 2 Personen. Mit dem 2. Schallwandler wird die Batteriebelastung leicht erhöht.

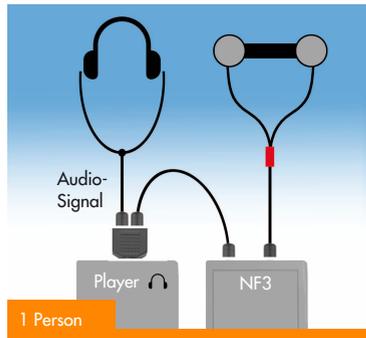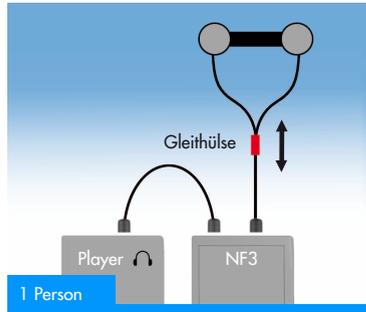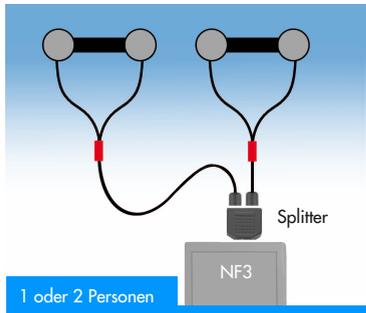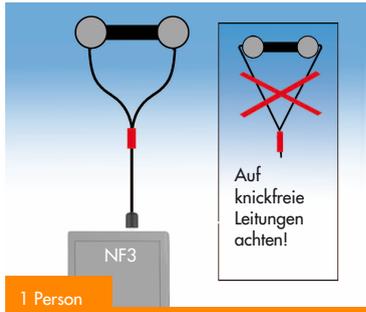

Ein Benutzerkreis entsteht durch 2 oder mehrere Personen (evtl. auch ein Tier), die sich z.B. an den Händen berühren. Die zwei Membranen des Schallwandlers werden wie 2 Hände einer Person in den Benutzerkreis einbezogen.

Ein NF3 für
drei!

Batteriewechsel



Schritt 1

Batteriestecker mit dem Holzstab **nur nach links drückend** lösen (siehe Pfeilrichtung).



Schritt 2

Neurophone NF3 wenden und die Batterie in die andere Handfläche fallen lassen.

Bearbeiten einer neuen Batterie



Schritt 3 / bei Bedarf

Bei jeder neuen Batterie den Ringkontakt mit dem entsprechenden Gegenkontakt einer gleichartigen Batterie ausweiten. Dadurch wird das Verbinden mit dem im Batteriefach liegenden Stecker erleichtert.



Schritt 4

Die betriebsbereite Batterie wie im Bild gezeigt auf den im Batteriefach gebliebenen Stecker drücken. Den Holzstab wieder zwischen der Seitenwand und dem Batteriestecker ablegen.

Batterieempfehlung

Die bei der Lieferung im NF3 eingebaute Batterie kann so lange genutzt werden, bis die Leuchtkraft der Leuchtdiode abnimmt. Bei auf etwa 3,5 Volt entladener Batterie kann das Ausgangssignal instabil werden. Selbst bei eventuellem Quietschton bestehen die nützlichen physiologischen Effekte des NF3. Als Stromquelle sind nicht aufladbare 9-Volt-Block Batterien (**45 g**) verwendbar oder z. B. Lithium-Akkus wie u.a. der Li-Ion-Typ 500 mAh von CONRAD Electronic (**nur 30 g**).

Dieser CONRAD-Akku wird durch interne Abschaltung bei ca. 5 Volt vor Tiefentladung geschützt. Es dürfen nur Lithium-Akkus mit der sogenannten PCB (Protection Circuit Board) Schutzfunktion verwendet werden.

Akku laden

Entladene Akkus sind in einem vom Akku-Hersteller empfohlenen Ladegerät gemäß dessen Bedienungsanleitung zu laden.

Original Flanagan CD mit Affirmationen

CD mit Wasserrauschen und Affirmationen in Deutsch und Englisch

Die Affirmationssätze sind je Titel drei mal im Wasserrauschen eingebettet. Affirmationen (kreative Gedanken) können Ihnen bei der Aneignung der von Ihnen gewollten Lebens- und Verhaltensweisen hilfreich sein. Das betrifft den tiefgehenden Zusammenhang von Istzustand, unterbewusste Ursache, neue Gedankenausrichtung. Sie können die Affirmationssätze auch individuell durch selbst gesprochene Sätze ersetzen. Das wird von vielen Experten empfohlen, so z. B. im Buch von Louise L. Hay „Du kannst es“. Sie gibt Nutzungshinweise in Bezug auf Affirmationen und sagt: „Was wir denken, das erschafft unsere Realität.“



CD mit Affirmationen

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1 Fließendes Wasser | 1 Flowing Water |
| 2 Energie | 6 Energy |
| 3 Geistiges Wachstum | 7 Mental Growth |
| 4 Lernen | 8 Learning |
| 5 Gesundheit | 9 Health |

Kraft der Pyramiden

Gleichzeitiges Tragen von
Neurophone NF3 und Sensor V
ermöglicht Synergie-Effekte.

Pyramiden Medaille Sensor V



Sensor V

Ein Prachtstück mit gebündelter Pyramidenkraft

Patrick Flanagans Arbeiten bewegen sich in der Bandbreite zwischen High-End-Technologien und Metaphysik. Als Wissenschaftler betritt er immer wieder Neuland und schafft interdisziplinäre Verbindungen; andererseits schöpft er sein Wissen und seine Entwicklungen aus einem fundierten spirituellen Hintergrund. Eines seiner zentralen Themen ist Lebens- bzw. Liebesenergie. Sein erklärtes Ziel, die Lebensqualität und Lebensdauer der Menschen deutlich steigern zu können, hat er mit seinen Entwicklungen bereits erreicht. (Katrín Klink)

Dr. Flanagan's Bestseller „Pyramid Power“ erschien 1975 in den USA.

Bronzeguss, galvanisch versilbert plus galvanisch vergoldet.

Durchmesser: 46 mm, Gewicht: 30 g



Sensor V - die Geschenk-Idee

Hanns Martin Strobel, Dipl.-Ing.(FH) / VDE

Ingenieurbüro Strobel
Pfinzingstraße 15
90537 Feucht
DEUTSCHLAND

Telefon: 0049 9128 729 -123, Fax: -125
Email: HMStrobel@nvc.de
www.neurophone-energy.com



ΦPHISCIENCES

PhiSciences Company, Inc.
271 S. Airport Road
Cottonwood, AZ, 86326
U.S.A.

Telephone: 001 928 634 2668
Fax: 001 928 649 0667
Email: Help@PhiSciences.com
www.phisciences.com

Dr. G. Patrick Flanagan und
Hanns Martin Strobel wünschen Ihnen guten
Nutzen und hilfreiche Erfahrungen mit Ihrem
Original Flanagan Neurophone NF3